



УТВЕРЖДЕНА ПРИКАЗОМ

от «26» октября 2019 г.

№ АА-492

25 ОКТ 2019

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц

РА.РУ 312808

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт-12»

наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

127287, г. Москва, ул.2-ая Хуторская, дом 38А, строение 3, этаж 1, помещение №1


адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений

шифр поверительного клейма

| № п/п | Измерения, тип (группа) средств измерений | Метрологические требования | | Примечание |
|---|---|--|--|------------|
| | | диапазон измерений | погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Измерения геометрических величин | | | | |
| 1 | Датчики направления ветра | 0...356° | ПГ ±4° | |
| 2 | Датчики осадков | 0,2...20 мм | ПГ ±(0,1+0,08·M _{изм}) мм | |
| 3 | Датчики состояния поверхности дорожного полотна | 0,1...4 мм | ПГ ±(0,05+0,2·C _{изм}) мм | |
| Измерения параметров потока, расхода, уровня, объема веществ | | | | |
| 4 | Датчики скорости воздушного потока | 0,7...30 м/с | ПГ ±(0,4+0,035·V) м/с | |
| Измерения давления, вакуумные измерения | | | | |
| 5 | Датчики атмосферного давления | 500...1100 гПа | ПГ ±1 гПа | |
| Теплофизические и температурные измерения | | | | |
| 6 | Датчики температуры дорожного покрытия | -50...50 °С | ПГ ±0,3 °С | |
| 7 | Датчики температуры и влажности воздуха | -40...50 °С 10...98 % | ПГ ±0,5 °С ПГ ±3...4 % | |
| Измерения электротехнических и магнитных величин | | | | |
| 8 | Контроллеры сигналов | 0,1...5 В 80...140 Ом 1...100 Гц | ПГ ±0,05 В ПГ ±0,04...0,1 Ом ПГ ±0,05 Гц | |

Генеральный директор
ООО «Стандарт-12»

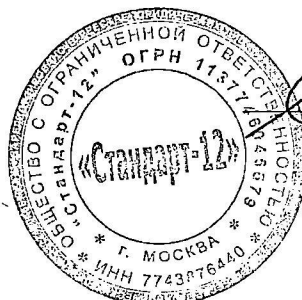

Подпись

В.М. Холодков